

# Pompa Steritest™ Symbio - Guida rapida dell'interfaccia utente

## Modalità standard

Premere per tornare alla schermata principale.

Premere per aprire la testa della pompa.

per 2 secondi per impostare il cronometro.

Nota: non è disponibile quando la pompa è in funzione.

in qualunque momento per regolare la velocità di rotazione della pompa.

### Utilizzando il cronometro

La pompa si ferma automaticamente al termine del periodo prestabilito.

Nota: per arrestare la pompa prima del termine preimpostato.




per selezionare la modalità standard.  
per impostare la modalità standard.



Installare sulla pompa il dispositivo Steritest™.  
Premere per chiudere la testa della pompa.



per avviare la pompa.

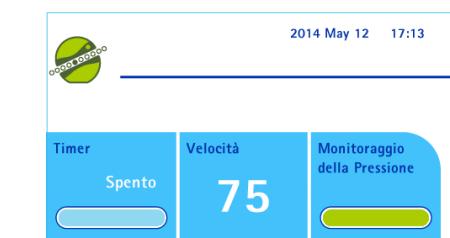

Identica alla modalità con monitoraggio della pressione a cui si aggiunge la regolazione automatica della velocità della pompa per ridurre la pressione nei canister.

per fermare la pompa.



Valore di riferimento della velocità



Regolazione automatica della velocità

## Configurazione della pompa

### Configurazione

Esci



#### Modalità pressione

- Interruttore a pedale
- Supporto per siringa
- Data e ora
- Lingua
- Informazioni sulla pompa
- Volume dell'allarme
- Luminosità
- Trasferimento dei metodi
- Configurazione di rete
- Verifica sensori pressione

## Modalità con monitoraggio della pressione

Il livello della pressione nei canister Steritest™ è indicato da una barra colorata.



**Verde:**  
pressione normale



**Arancione:**  
pressione elevata



**Rosso:**  
pressione eccessiva   
Si consiglia di fermare la pompa.

## Modalità con regolazione della pressione

Nota: non compatibile con l'impiego del cronometro e con il supporto della siringa.

Identica alla modalità con monitoraggio della pressione a cui si aggiunge la regolazione automatica della velocità della pompa per ridurre la pressione nei canister.





Valore di riferimento della velocità

Regolazione automatica della velocità

## Modalità Metodo analitico

Nota: questa modalità è accessibile solo se nella pompa sono stati precedentemente caricati dei metodi analitici, utilizzando il software Symbio Steritest™.

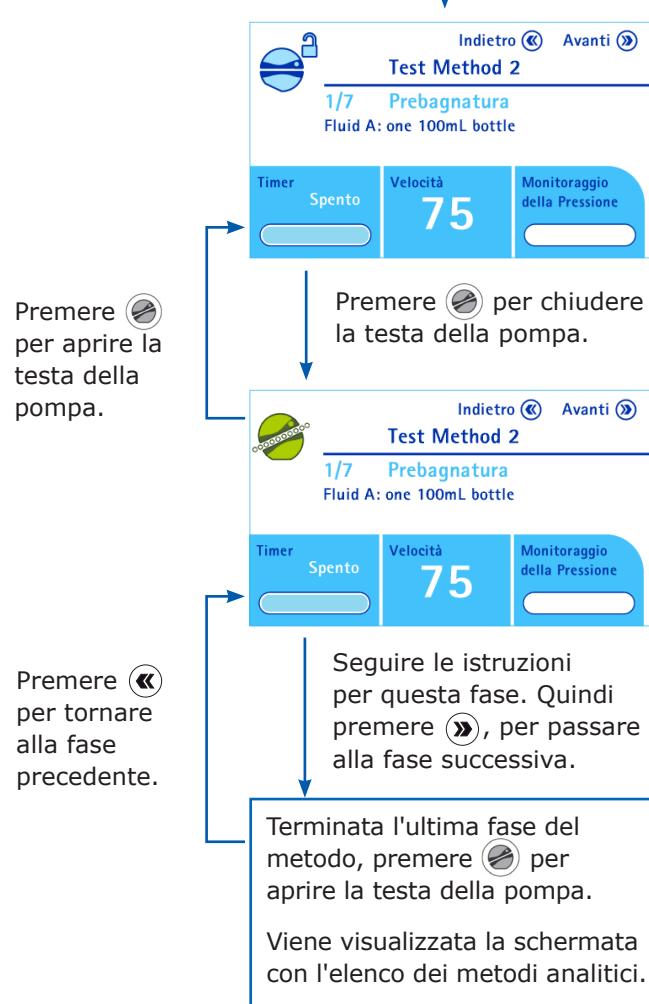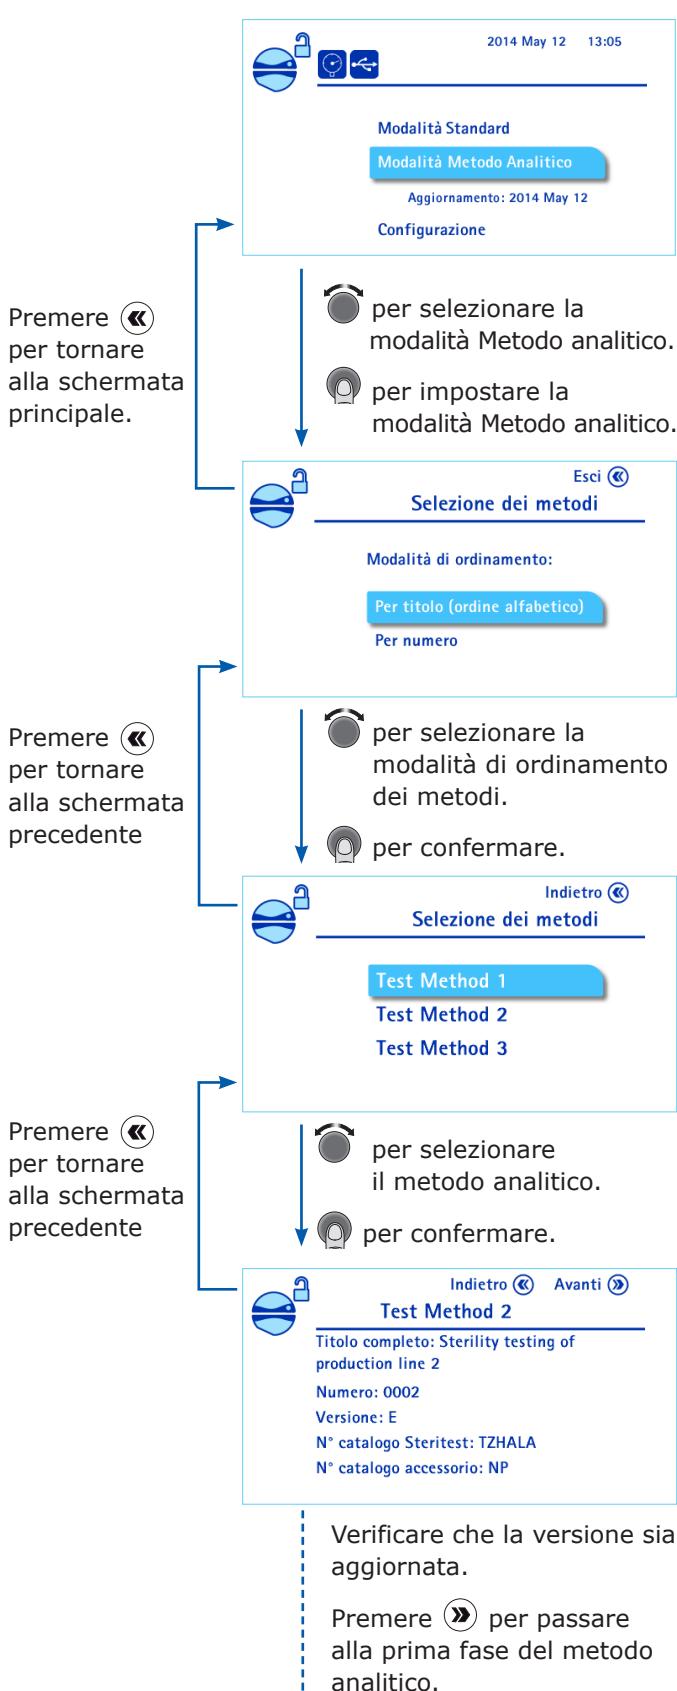

## Gestione dei parametri di filtrazione nella modalità Metodo analitico

Nella modalità Metodo analitico i parametri di filtrazione sono predefiniti

Regolazione della velocità di rotazione della pompa

per regolare la velocità di rotazione della pompa.

Regolazione del cronometro

Il valore preimpostato per il cronometro non può essere modificato.

per arrestare la pompa prima del termine prestabilito.

Modalità pressione

La modalità predefinita per il controllo della pressione non può essere modificata. Consultare il paragrafo "Modalità standard" sull'altra pagina della presente Guida rapida.

Nota: per scaricare il manuale d'uso completo delle pompe Steritest™ Symbio, consultare la pagina [www.millipore.com/steritest-symbio](http://www.millipore.com/steritest-symbio).

© 2019 Merck KGaA, Darmstadt, Germania e/o sue affiliate. Tutti i diritti sono riservati.

Merck, Steritest, Sigma-Aldrich e Millipore sono marchi di Merck KGaA, Darmstadt, Germania o di sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei legittimi detentori. Informazioni dettagliate sui marchi sono disponibili tramite risorse pubblicamente accessibili. PF16602IT Versione 3.0 01/2019

Negli USA e in Canada, il settore life science di Merck KGaA, Darmstadt, Germania opera con il nome di MilliporeSigma.

**MERCK**